

Insteltechniek mammografie


Landelijke Referentiecentrum voor
Bevolkingsonderzoek




Standaardprojecties

- Cranio-caudaal (CC)
- Mediolatero-oblique (MLO)




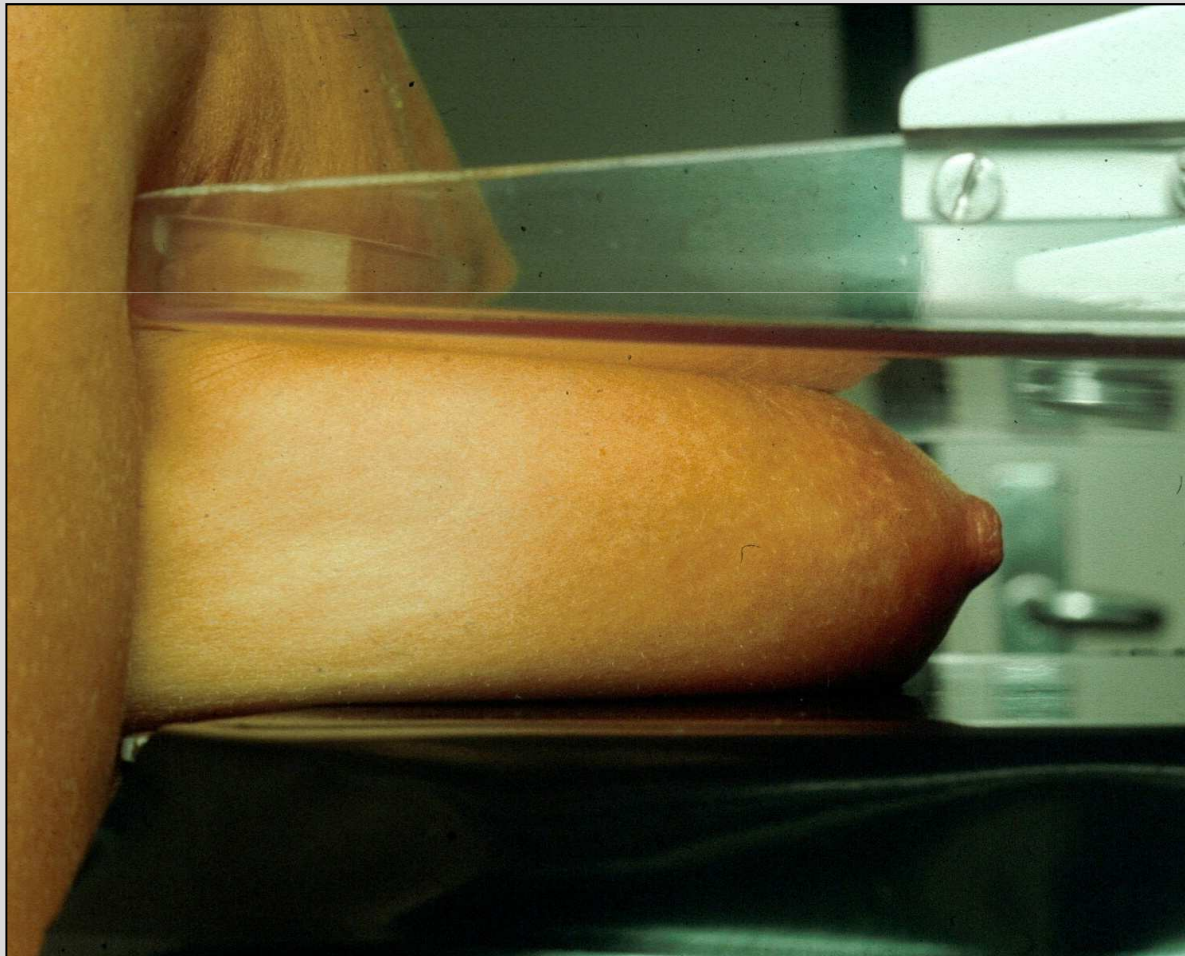


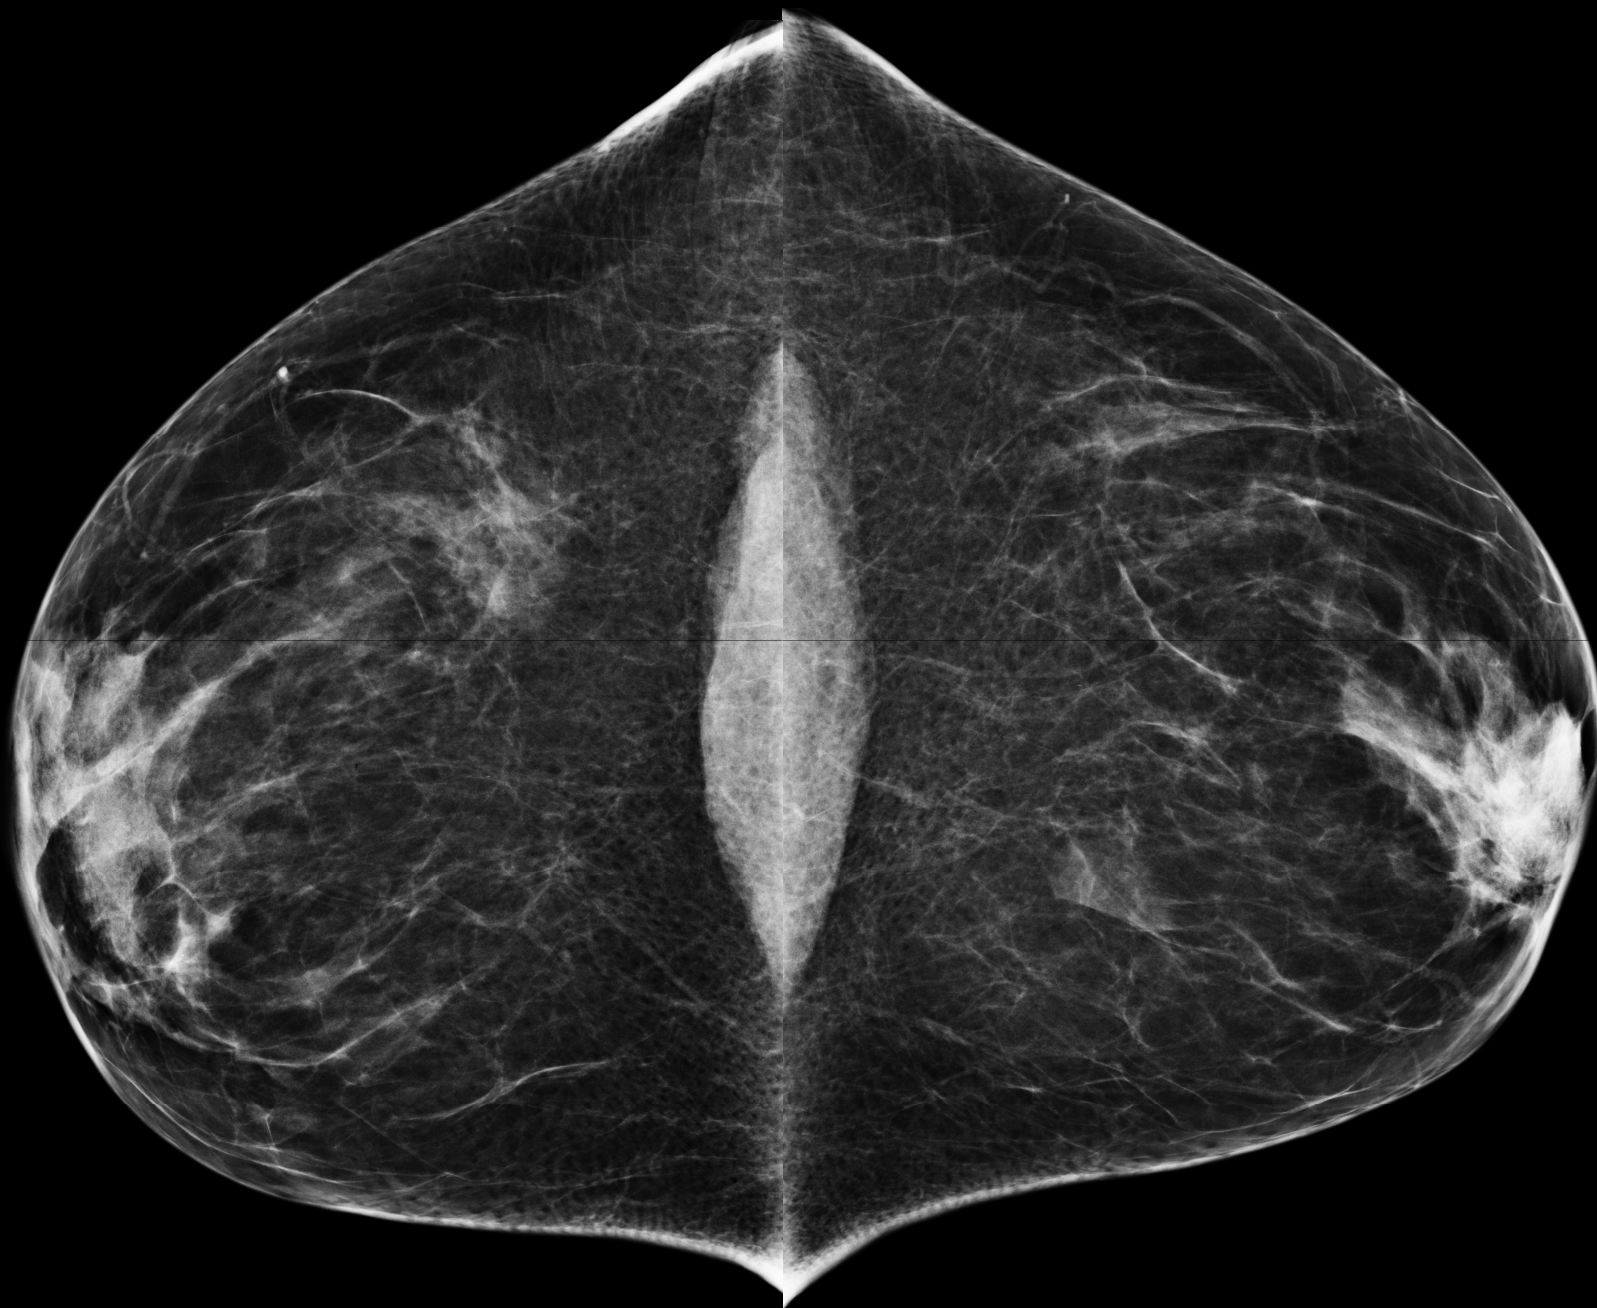

CC - opname

- zoveel mogelijk klierweefsel afgebeeld (maximaal aan mediale zijde en zoveel mogelijk aan laterale zijde)
- tepel in het midden gepositioneerd en buiten het klierweefsel (en profile)
- indien mogelijk musculus pectoralis major afgebeeld (50-60%)

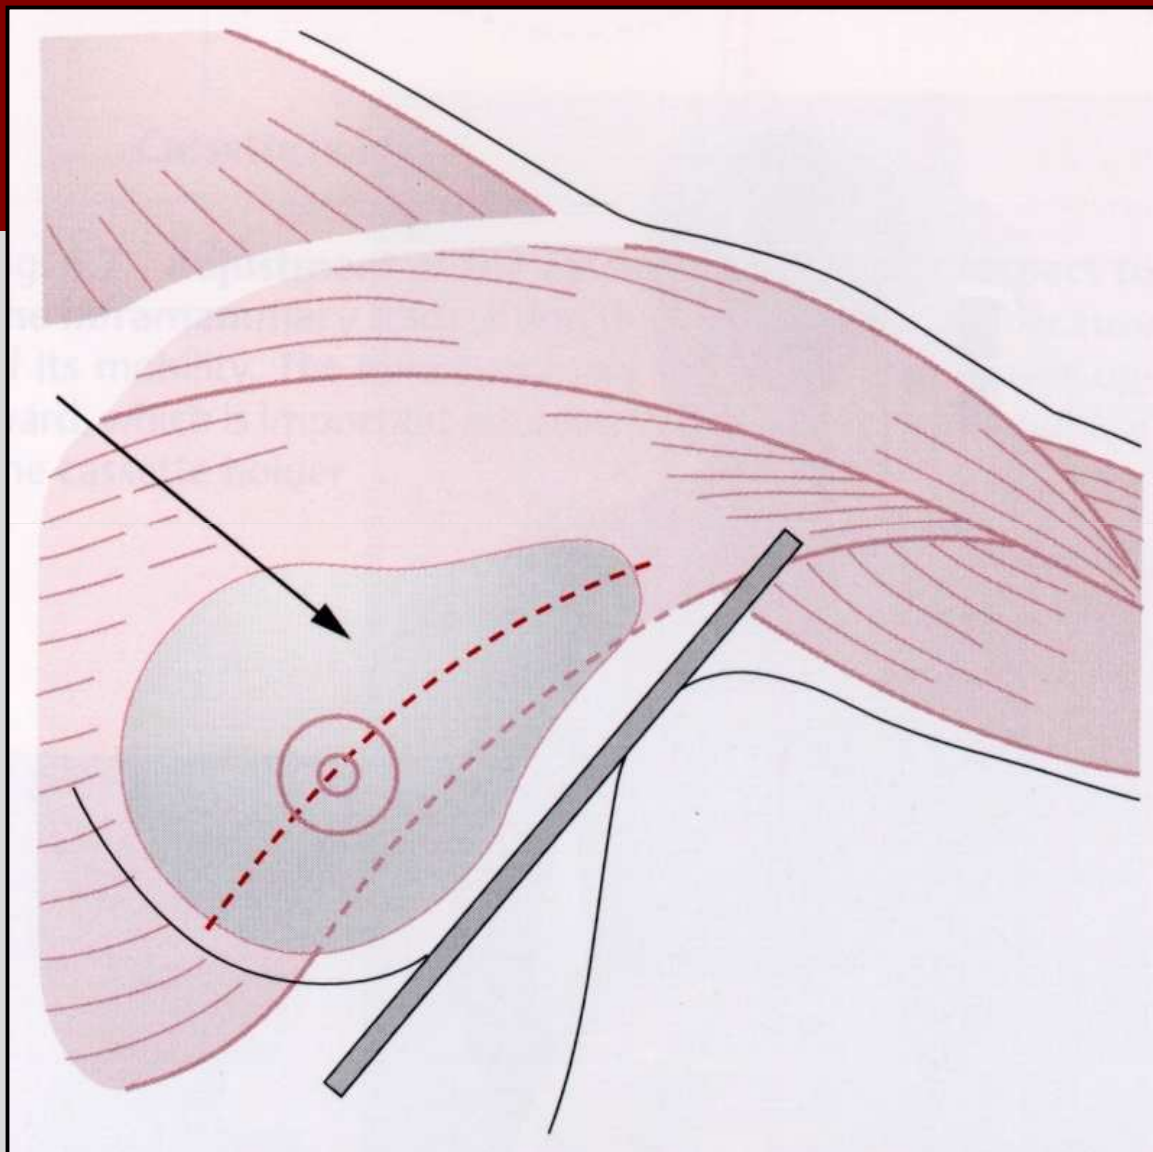

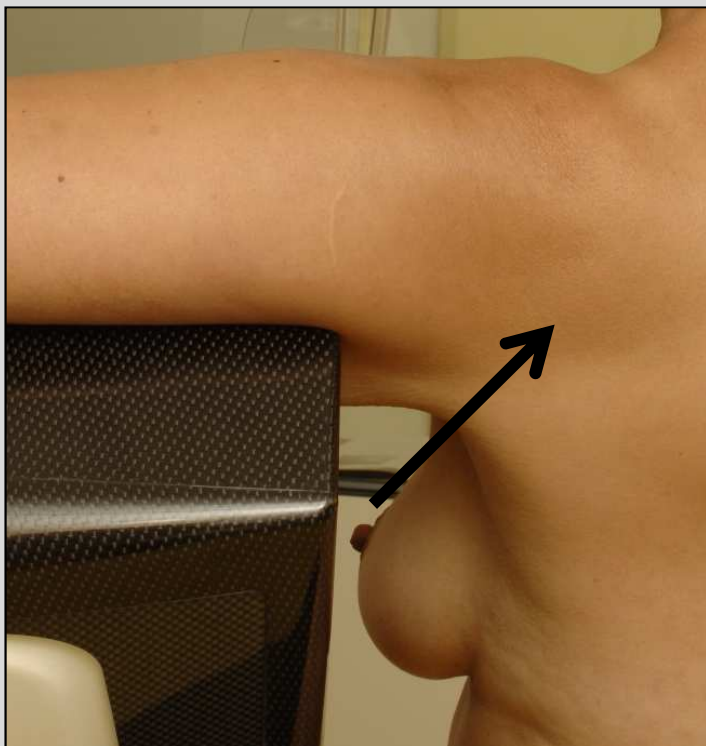






MLO - opname

- gehele klierweefsel afgebeeld
- m. pectoralis tot aan tepelniveau en voldoende breed
- tepel buiten mammaweefsel geprojecteerd
- borst-buikovergang afgebeeld

Algemene kwaliteitscriteria

- Uniform, reproduceerbaar mammogram
- Goede compressie
- Correcte beeldvorming
- Geen bewegingsonscherpte
- Geen huidplooien
- Geen over projecterende delen (kin, schouder, haren)
- Correcte markering en identificatie
- Symmetrische opnamen

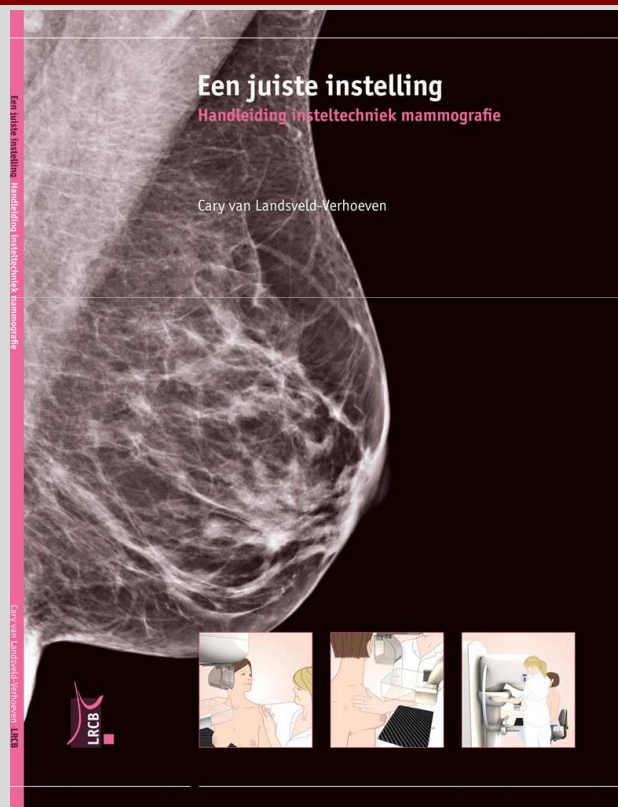

Insteltechniek mammografie

Het maken van goed vergelijkbare mammogrammen is van groot belang, zodat de opnamen van achtereenvolgende onderzoeken met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor kunnen ontstane tumoren vroegtijdig worden ontdekt.

Algemene kwaliteitscriteria

- De maatregelen zijn uniform en reproduceerbaar;
- Er zijn geen plussen of minnen;
- Er zijn geen overprojecties/deel van zichtbaar, maar ondoelbaar, niet te horen;
- De componenten die worden getoond zijn eenvoudig;
- Er is geen bewijs van een bepaalde aanpak;
- Er zijn geen technische problemen met betrekking tot de getoonde resultaten;
- De resultaten zijn duidelijk af te zien van andere resultaten.

[illegible]

*zie www.lrcb.nl

Kwaliteit telt